Hoja de datos de presentación

Características y beneficios:

- **Garantía limitada de cinco años para repuestos y de un año para mano de obra***
- Conexiones estándar de 19 mm y 30 mm
- Diseños disponibles con montajes de pared, de consola, en el techo y de superficie
- Compensa las variaciones de espesores de pared hasta 7/8 pulg
- Diseño modular extraíble
- Todas las salidas están completamente comprobadas para determinar la presencia de fugas y de flujo
- Placas frontales completamente escalonadas, con códigos de color

*Para obtener la información completa, vea Términos y Condiciones, documento n.° 99-0477, en nuestro sitio web: www.tri-techmedical.com.

Salida empotrada de pared XF1133, se muestra arriba

Especificación
Las salidas de pared del gas medicinal son salidas Tri-Tech Medical AGSS (de evacuación) para la recolección de gas de baja presión, con accesorios cónicos de 19 mm y 30 mm que facilitan la conexión con la tubería de desecho del gas para anestesia estándar. Las salidas son simples y modulares e incorporan todos los códigos de color de las placas frontales. Las salidas simples modulares deben tener un diseño que ofrezca la extracción de las placas de la caja oculta en el campo para formar múltiples. Los servicios de gas se organizarán de manera secuencial y se ubicarán según se muestra en los planos, con una separación de la línea central mínima de 5 pulgadas (12,7 cm) entre las salidas.

La placa de identificación de salida tendrá una escala con código de color permanente. La placa frontal de salida será de zinc cromado, que se fijará con la placa de identificación en el ensamblaje de la caja oculta y brindará un ajuste automático del yeso de 1/2 a 7/8 de pulgada (13 a 22 mm). El nombre del servicio de gas deberá quedar permanentemente estampado en el soporte de salida. El tubo de alimentación de la caja oculta de la salida será de 7 pulg (18 cm) de largo, de 3/4 de diám. exterior, de cobre tipo K, y deberá tener la etiqueta con el nombre del servicio de gas.

Las salidas del gas medicinal deben limpiarse para realizar el servicio de oxígeno según el folleto G-4.1 de la Asociación de Gas Comprimido (Compressed Gas Association, CGA, taparse y colocarse en un recipiente de protección para el envío. Las salidas deben instalarse cumpliendo estrictamente con las instrucciones del fabricante y probarse antes de ser utilizadas de conformidad con los códigos locales y federales.

Diseño

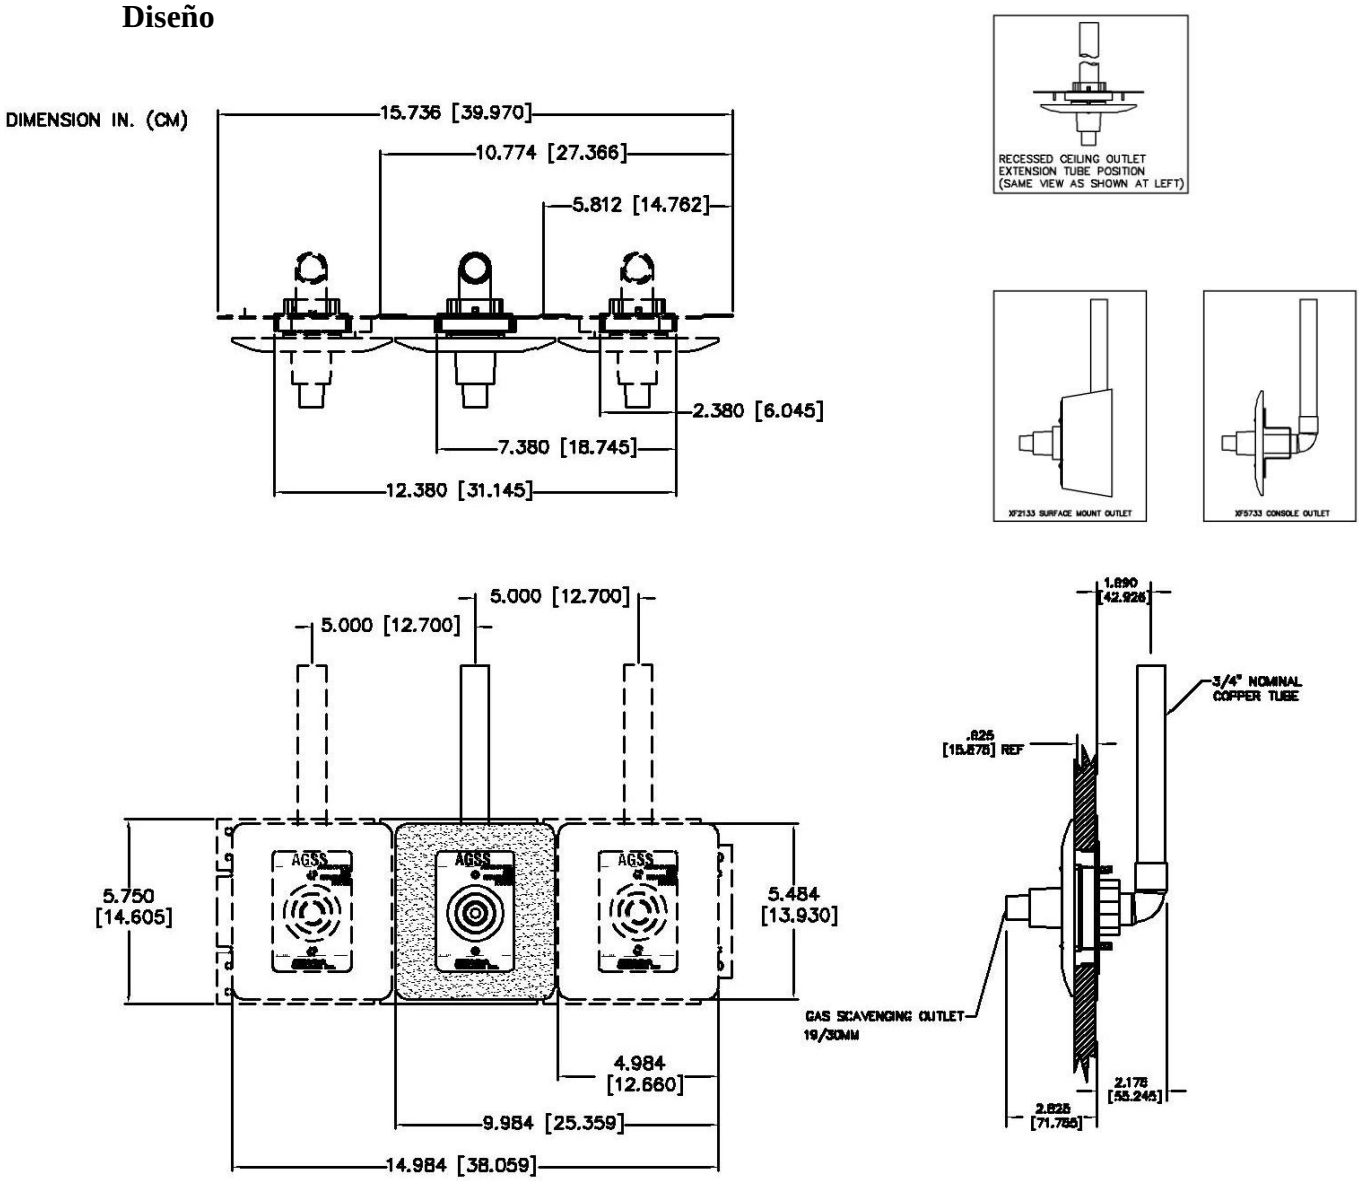

Información para pedidos

Salidas empotradas estándar completas, con marco adaptador

Servicio de gas	Empotrada en pared	Empotrada en techo	Montaje en superficie	Consola
AGSS NFPA	XF1133	XF1233	XF2133	XF5733
AGSS ISO Inglés, francés	NSI12XF1133	NSI12XF1233	NSI12XF2133	NSI12XF5733

Para realizar un pedido o solicitar información adicional, llame sin cargo al 1-800-253-8692 o envíenos un fax al 1-440-937-5060 o un correo electrónico a internationalsales@tri-techmedical.com. Visite nuestro sitio web en www.tri-techmedical.com.